



常州检验检测标准认证研究院

Changzhou Institute of Inspection Testing Standardization and Certification

校准证书

Calibration Certificate

证书编号: 123038933A006 号

Certificate No.



委托方

Customer

优利德科技(中国)股份有限公司

委托方地址

Address of Customer

广东省东莞市工业北一路6号

样品名称

Name of Instrument

便携式单一气体检测仪

型号/规格

Type /Specification

UT334-ETO

样品编号


Sample No.

20230950393

制造单位

Manufacturer

优利德科技(中国)股份有限公司

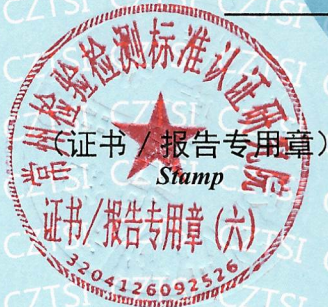

校准
Calibrated by

钱志光

核验
Checked by

梅青

批准
Approved by

梅青

批准日期
Authorize Date

2023 - 09 - 25

样品接收日期

Date of Received

2023

年

Year

09

Month

月

22

Day

日

校准日期

Date of Calibrated

2023

年

Year

09

Month

月

25

Day

日

地址: 常州市武进区鸣新中路16号(计量基地)

Address

邮政编码: 213164

Post code

电话: 4008580800

Tel.

网址: <http://www.cztsi.com>

Website

监督电话: 0519-86290020

Tel.for Complain

传真: 0519-81002098

Fax

说明

编号：第 123038933A006 号

No.

Directions

第 2 页 共 3 页

Page

of

本实验室是国家法定计量检定机构，计量授权证书号：（苏）法计（2023）10072 号、（苏）法计（2023）20022 号。

This laboratory is a national legal metrological verification institute. Authorization certificate: (苏)法计(2023)10072号、(苏)法计(2023)20022号.

本次校准的技术依据：

Reference documents for the Calibration

参照 JJF 1172-2007《挥发性有机化合物光离子化检测仪校准规范》

Product Manual《设备说明书》

本次校准所使用的主要计量器具：

Major measuring instruments used in the Calibration

名称

测量范围

不确定度或准确度等级或最大误差

证书编号/溯源机构

有效期至

Name

Measuring range

Uncertainty or Accuracy Class or MPE.

Certificate No./Testing institute

Due Date

空气中异丁烯
气体标准物质

0.102%、0.2
02%

$U_{rel}=2\%$, $k=3$

GBW(E)081668/
中国测试技术研
究院

2023-10-24

多组分动态
配气系统

/

$U_{rel}=1.3\%$, $k=2$

HJqt2023-02791/
中国计量科学研
究院

2024-05-25

校准地点、环境条件：

Place and environmental conditions of the Calibration

地点：

本院鸣新中
路16号420
实验室

温度：

(24.2 ~ 24.5)°C

相对湿度：

(60 ~ 63)%

大气压：

/ kPa

Place

Temperature

R.Humidity

Air pressure

校准结果

编号: 第 123038933A006 号

Results of Calibration

第 3 页 共 3 页
Page of

测量组分	标准值 ($\mu\text{mol/mol}$)	平均值 ($\mu\text{mol/mol}$)	重复性	相对扩展不确定度 $U_{\text{rel}}(k=2)$
异丁烯	101	92.6	0.6%	2%

备注: 仪器声光报警正常, 且经客户委托, 本次校准仅涉及以上校准项目及校准点。

以下空白



本证书/报告替代原“123038933-006号”的证书, 原证书声明作废。

注: 1. 本校准结果只对所校准样品有效。

Note: The results are only responsible for the items calibration.

2. 未经本实验室书面批准, 不得部分复制本校准证书。

This certificate of calibration shall not be reproduced except in full, without the written approval of the laboratory.

3. 本证书未加盖证书/报告专用章无效。

This certificate will be invalid if it is issued without official stamp.